
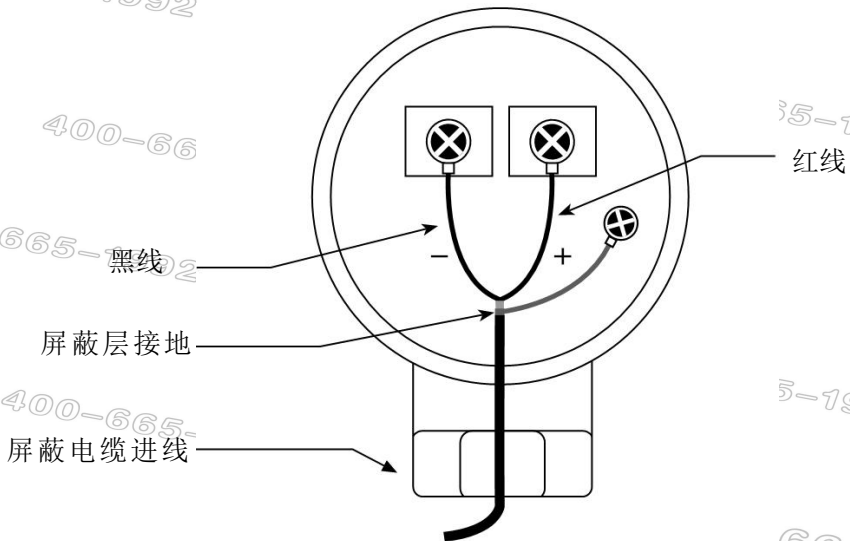


插入式传感器安装方法

请安装人员认真阅读以下要求，按下图的示意方法安装插入式传感器。




注意：安装时需将压力降到 8 公斤以下，正常运行时最高耐力 25 公斤。

1、工艺要求：

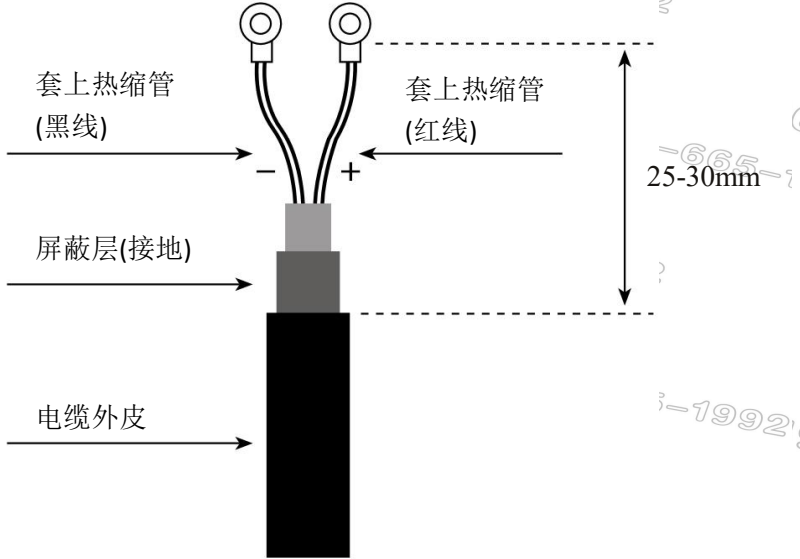

2、插入式传感器的密封要求：

调正传感器方向→接线→拧紧电缆锁紧螺母→按上密封圈→拧上接线盒盖→用两个活扳手较紧

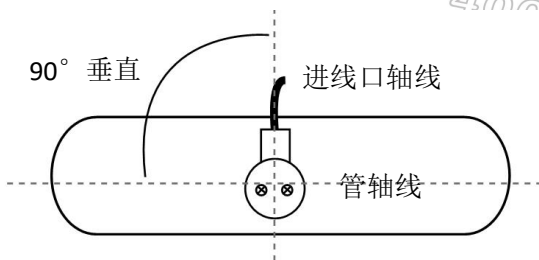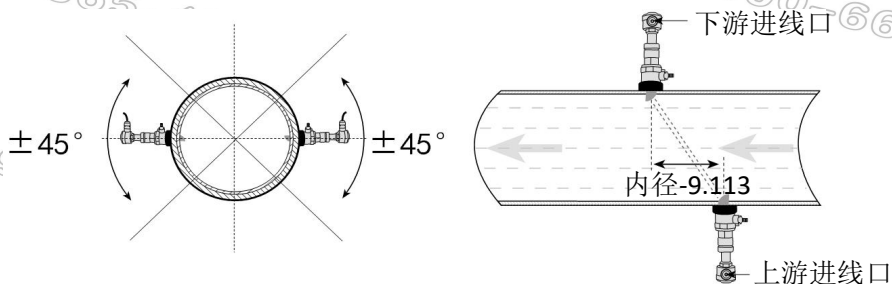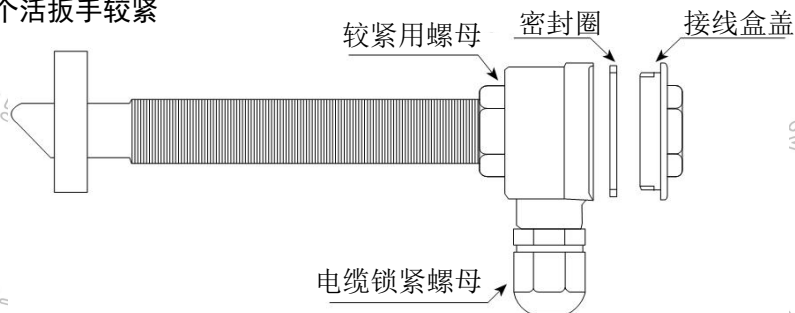

两个传感器的进线口朝向一致，并且所指的方向与管道的轴线垂直（这样才能保证两个传感器的发射面相对）。

注意事项：

- 1、电缆锁紧螺母只有锁住专用电缆的外皮才能达到密封效果。
- 2、用两个扳手将接线盒盖较紧后，才能将密封圈挤压变形从而达到密封效果。
- 3、以上方法已经过充分的实践验证，要求安装人员一定要按照上述步骤操作，否则会由于密封不好，日久天长，水或潮气一点点的渗入，引起超声波流量计工作异常的严重后果。

全国统一服务热线：400-665-1992

大连海峰伟业仪器有限公司

地址：大连市甘井子区张前路 588 号 A 区 4 号

总机：0411-86867704 86867705 86867706 86867756

传真：0411-86867753

<http://www.hf2000.cn>

